

## Matéria sólida suspensa 50

M383

10 - 750 mg/L TSS

Turbidez / Método de Radiação  
Atenuada

### Informação específica do instrumento

O teste pode ser realizado nos seguintes dispositivos. Além disso, a cubeta necessária e a faixa de absorção do fotômetro são indicadas.

Dispositivos	Cuvette	$\lambda$	Faixa de Medição
SpectroDirect, XD 7000, XD 7500	□ 50 mm	810 nm	10 - 750 mg/L TSS

### Material

Material necessário (parcialmente opcional):

Reagentes	Unidade de Embalagem	Código do Produto
não é necessário reagente		

### Lista de Aplicações

- Tratamento de Água Potável
- Tratamento de Esgotos
- Tratamento de Água Bruta


### Amostragem

1. Medir a amostra de água logo após a recolha da amostra. As amostras podem ser guardadas até 7 dias a 4 °C em garrafas de plástico ou de vidro. A medição devia ser efetuada à mesma temperatura da recolha da amostra. As diferenças de temperatura entre a medição e a recolha da amostra podem alterar o resultado de medição.



## Notas

1. A determinação fotométrica da matéria sólida suspensa baseia-se num método gravimétrico. Num laboratório procede-se à evaporação do resíduo de filtração de uma amostra de água filtrada normalmente num forno a 103 °C - 105 °C, e o resíduo seco é equilibrado.
2. Se precisar de mais precisão, deve realizar uma determinação gravimétrica de uma amostra. Este resultado pode ser usado para um ajuste do utilizador do fotómetro com a mesma amostra.
3. O limite de prova estimado para este método situa-se em 20 mg/L TSS.




## Realização da determinação Matéria sólida suspensa


Escolher o método no equipamento.

Para este método, uma medição ZERO não precisa ser realizada todas as vezes nos seguintes dispositivos: XD 7000, XD 7500


Homogeneizar 500 mL da amostra de água num misturador a alto nível durante 2 minutos.




Encher a **célula de 50 mm** com **água desmineralizada**.




Colocar a **célula zero** no compartimento de medição. Observar o posicionamento.



Premir a tecla **ZERO**.




Retirar a **célula** do compartimento de medição.




Esvaziar a **célula**.


Nos equipamentos que **não requerem uma medição ZERO**, deve começar aqui.




Misturar bem a amostra de água homogeneizada.



Enxaguar a **célula** com amostra preparada.




Encher a **célula de 50 mm** com **amostra**.

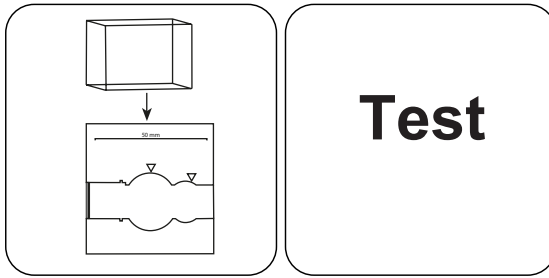

Colocar a **célula de amostra** no compartimento de medição. Observar o posicionamento.

Premir a tecla **TEST** (XD: **START**).

No visor aparece o resultado em mg/L TSS (Total de Sólidos Suspensos).



## Método Químico

Turbidez / Método de Radiação Atenuada

## Apêndice

### Função de calibração para fotômetros de terceiros

$$\text{Conc.} = a + b \cdot \text{Abs} + c \cdot \text{Abs}^2 + d \cdot \text{Abs}^3 + e \cdot \text{Abs}^4 + f \cdot \text{Abs}^5$$

	□ 50 mm
a	$8.02365 \cdot 10^{-0}$
b	$1.44739 \cdot 10^{-2}$
c	$7.70483 \cdot 10^{-1}$
d	$-3.84183 \cdot 10^{-1}$
e	$9.71408 \cdot 10^{-0}$
f	

### Texto de Interferências

#### Interferências Removíveis

- As bolhas de ar interferem e podem ser removidas se agitar ligeiramente a célula.
- A cor interfere quando a luz é absorvida a 660 nm.

### Validação de método

Limite de Detecção	0.42 mg/L
Limite de Determinação	1.27 mg/L
Fim da Faixa de Medição	750 mg/L
Sensibilidade	272.94 mg/L / Abs
Faixa de Confiança	3.96 mg/L
Desvio Padrão	2.06 mg/L
Coefficiente de Variação	0.54 %

#### Derivado de

EN 872:2005